


スミフェロン注DSの取り扱い方法

監修：大阪府済生会吹田病院 名誉院長 岡上 武

形状



■ 注射の準備

1 手指を石けん等で洗い、清潔なタオル等で水気を拭き取ってください。

2 フィンガーグリップ (白色の部分) をしっかり握って固定し、先端キャップ (封かんシール付) を回してねじりながら引き抜きます。



3 フィンガーグリップをしっかりと握って固定してください。ゴムキャップ側を上にして、ゴムキャップをゆっくり前後左右にずらすようにして外します。外した後は、ガラスシリンジの先端には、さわらないでください。

- ゴムキャップは衛生管理上固めに取り付けてあります。ゴムキャップを取り外す際に保護カバー (透明の部分) を握ると、カバーが外れることがあります。



4 添付されている注射針をしっかりと取り付けます。



5 フィンガーグリップ (白色の部分) をしっかり持って、保護カバー (透明の部分) を回しながら取り外します。



6 注射器の先を上に向け横から軽く指ではじき、空気を上に集めます。次いで、プランジャー (白色) をゆっくり押し上げ、注射器内の空気を抜いてください。この時、針先から薬液が出る事を確認してください。

- 気泡が外へ出にくい場合は、これを繰り返してください。多少の気泡が残っていても問題ありません。



● 使用方法

注射の方法と投与回数は必ず主治医の指示に従ってください。使用は1本につき1回限りとし、開封後は速やかにご使用ください。

● 保存方法

冷蔵庫内に食物などと区別して清潔に保存してください。また、遮光し、凍結を避け、10℃以下で保存してください。冷蔵庫内の保管場所によっては凍結することもありますので、冷風吹き出し口付近など比較的低温となる場所には置かないでください。薬剤を冷えたまま注射すると、痛みが増すことがありますので、投与する少し前より冷蔵庫から出しておいてください。

天然型 インターフェロン-α 製剤 製薬基準収載
生物由来製品・創薬・処方箋医薬品 (注) 一部特殊な処方により使用すること


スミフェロン[®]注 DS 300万IU・600万IU
Sumiferon 日本薬局方 インターフェロン アルファ (NAMALWA) 注射液

製造販売元 (文献請求先及び問い合わせ先)
住友ファーマ株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町 2-6-8

〈製品に関するお問い合わせ先〉
くすり情報センター
TEL 0120-034-389
受付時間 / 月～金 9:00～17:30 (祝・祭日を除く)
<https://sumitomo-pharma.jp/>

注射部位 (一か所に集中しないように心がける)

皮下注射 神経、血管が少なく、皮膚表面の近いところで骨がない場所。
一般に上腕伸側、大腿前面がよく用いられます。

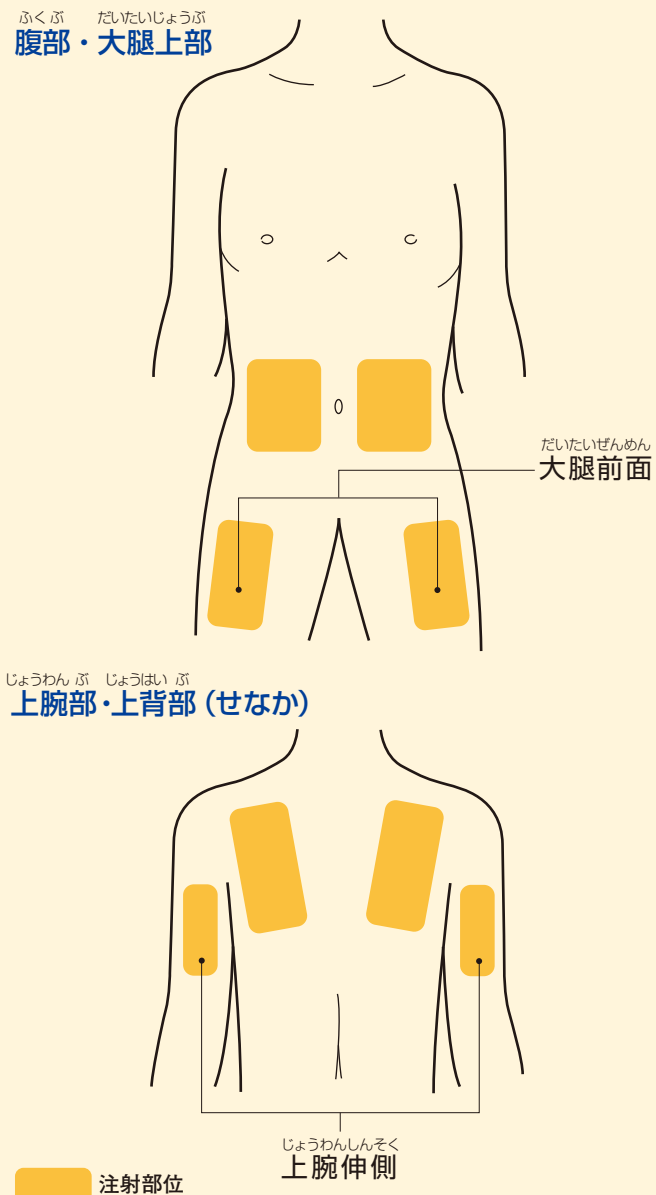

注射直前の注意

- フィンガーグリップとプランジャーに指をかけて投与します。注射の方法と投与回数は必ず主治医の指示に従ってください。
注意：格納筒部分(透明の部分)に指をかけると、スムーズな格納操作ができません。必ずフィンガーグリップに指をかけて投与してください。

■ 注射の仕方

皮下注射

- 1 注射する場所を消毒用アルコール綿で広く拭きます。
- 2 注射器を水平に持ち注射針キャップをひねらずまっすぐ外します。
● 注射針キャップをひねると針ごと外れることがあります。また、キャップを外すときの反動による針刺し事故に注意してください。
- 3 注射部位のまわりの皮膚を親指と人差し指でつまみます。注射器を、この部位に皮膚面と約30~45°の角度で素早く針をさします。
- 4 プランジャーを少し引き、血液が逆流しないことを確認し、ゆっくり注射液を注入します。
- 5 注射し終わったら針を引き抜き、注射した場所を消毒用アルコール綿で軽くおさえます。



■ 投与直後〈針の格納〉

- 1 投与終了後、注射針を投与部位から外します。そのまま針先を人のいる方向に向けないように注意して、さらにプランジャーを強く押ししてください。フィンガーグリップが後退して注射針が格納筒に引き込まれます。



- 2 注射針が格納筒に完全に引き込まれ、カチッと音がするまでプランジャーを強く押ししてください。カチッと音がすると注射針が固定されて格納操作は終了します。注射針が格納筒に完全に引き込まれていることを目で確認し、その後注射針の周りに指を触れないように注意して速やかに廃棄してください。



使用後の注意

- 使用後は分解・分別は絶対に行わず、速やかに廃棄してください。
- 投与後の注射器は、感染性廃棄物となります。一般の廃棄物とは絶対に一緒にしないでください。
- 廃棄方法に関しましては、主治医の指示に従ってください。